



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

<http://www.ibf.com.br>

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Dados da Empresa		
Razão Social: IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A		
CNPJ: 33.255.787/0001-91	Insc. Estadual: 80.652.712	
Endereço: Rua Dr. Sabino Arias, 187, Mantiquira, Duque de Caxias, RJ – CEP: 25.250-613		
Telefone: (21) 2103-1044 / (85) 98151-2946	E-mail: licitacoes@ibf.com.br / fiferlandes@ibf-mail.com.br	
Banco: Banco do Brasil (001)	Agência: 3437-1	Conta Corrente: 110.000-9
Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato		
Nome: Ilacir Resende Ferreira		
Cargo: Gerente Nacional de Vendas		
Nacionalidade: Brasileiro / Naturalidade: Minas Gerais / Estado Civil: Casado / Profissão: Comerciante		
Endereço: Rua Lauro Müller, nº 116, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 22.290-900		
RG: 13.237.854	Órgão Expedidor: SSP/MG	CPF: 109.111.098-03
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias		Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias		Garantia: 12 (doze) meses

IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A – CNPJ: 33.255.787/0001-91 – I.E. : 80.652.712
Matriz: Rua Doutor Sabino Arias, 187, Mantiquira – Duque de Caxias / RJ - Cep:25250-613 Tel.: (21)2103-1044 e-mail: licitacoes@ibf.com.br
RJ - : Rua Lauro Müller, 116/10º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-900 - Tel.: (21)2103-1000
SP - Av. Pedro Bueno, 1.028 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04342-000 - Tel.: (11) 2103-2000

Página 1 de 3

(Handwritten marks and signatures)



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

<http://www.ibf.com.br>

Item	Unid	Qtd	Descrição	Marca / Modelo / Reg. ANVISA	Valor Unitário	Valor Total
1	Unid	1	CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (MULTICASSETES) / Sistema DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA E RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO, MULTCASSETE, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS /MM EM TODOS OS TAMAÑHOS DE CASSETES PARA RAIOS-X. DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20 PIXELS / MM NOS TAMAÑHOS DE CASSETES 18 X 24 CM E 24 X 30 CM. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 90 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. RESOLUÇÃO DE 12 BITS. CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR (LCD) DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS E SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 2 GB, DISCO RÍGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) NO MÍNIMO 2000 IMAGENS E LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM POR CONTROLE DE RANGE DINÂMICO E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0. STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. CASSETES PARA O DIGITALIZADOR MULTCASSETE DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA: 4 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24 X 30 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 35 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24 X 30 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18 X 24 CM. Sistema DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMAÑHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 3,2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO	AGFA / CR DXM / 80497200010	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00

IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A - CNPJ: 33.265.787/0001-91 - I.E. : 80.652.712
Matriz: Rua Doutor Sabino Arias, 187, Mantiqueira - Duque de Caxias / RJ - Cep:25260-813 Tel.: (21)2103-1044 e-mail: licitacoes@ibf.com.br
RJ - : Rua Lauro Müller, 118/10º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-900 - Tel.: (21)2103-1000
SP - Av. Pedro Bueno, 1.028 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04342-000 - Tel.: (11) 2103-2000

Página 2 de 3

Handwritten marks and signatures.




INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

<http://www.ibf.com.br>

		PADRAO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MEDICAS, COM IMPRESSAO DE TECNOLOGIA E RESOLUCAO MINIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 100 FILMES. CONEXAO COM MODALIDADES ATRAVES DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 12 BITS. TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). v.u.: trezentos e quinze mil reais. v.t.: trezentos e quinze mil reais.			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (trezentos e quinze mil reais)					R\$ 315.000,00


- Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os impostos e taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega dos materiais ofertados.

Duque de Caxias, 30 de Junho de 2022.


IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.
CNPJ: 33.255.787/0001-91
Ilacir Resende Ferreira
CPF: 109.111.098-03

IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A - CNPJ: 33.255.787/0001-91 - I.E.: 80.652.712
Matriz: Rua Doutor Sabino Arias, 187, Montiquira - Duque de Caxias / RJ - Cep: 25260-613 Tel.: (21) 2103-1044 e-mail: licitacoes@ibf.com.br
RJ - Rua Lauro Müller, 118/10º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-900 - Tel.: (21) 2103-1000
SP - Av. Pedro Buene, 1.028 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04342-000 - Tel.: (11) 2103-2000

Página 3 de 3



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

<http://www.ibf.com.br>

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Dados da Empresa		
Razão Social: IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A		
CNPJ: 33.255.787/0001-91	Insc. Estadual: 80.652.712	
Endereço: Rua Dr. Sabino Arias, 187, Mantiquira, Duque de Caxias, RJ – CEP: 25.250-613		
Telefone: (21) 2103-1044 / (85) 98151-2946	E-mail: licitacoes@ibf.com.br / fjfernandes@ibf-mail.com.br	
Banco: Banco do Brasil (001)	Agência: 3437-1	Conta Corrente: 110.000-9
Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato		
Nome: Ilacir Resende Ferreira		
Cargo: Gerente Nacional de Vendas		
Nacionalidade: Brasileiro / Naturalidade: Minas Gerais / Estado Civil: Casado / Profissão: Comerciante		
Endereço: Rua Lauro Müller, nº 116, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 22.290-900		
RG: 13.237.854	Órgão Expedidor: SSP/MG	CPF: 109.111.098-03
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias		Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias		Garantia: 12 (doze) meses

IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A – CNPJ: 33.255.787/0001-91 – I.E.: 80.652.712
Matriz: Rua Doutor Sabino Arias, 187, Mantiquira – Duque de Caxias / RJ - Cep: 25250-613 Tel.: (21)2103-1044 e-mail: licitacoes@ibf.com.br
RJ - : Rua Lauro Müller, 116/10º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-900 - Tel.: (21)2103-1000
SP - Av. Pedro Bueno, 1.028 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04342-000 - Tel.: (11) 2103-2000

Página 1 de 3

Handwritten signatures and initials.



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

<http://www.ibf.com.br>

Item	Unid	Qtd	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Unid	1	SISTEMA MULTICASSETE DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS Marca AGFA, Modelo CR DX-M, Reg. Anvisa: 80497200010 para aquisição digital, tratamento e gravação de imagens digitais de raios-x e mamografia, com capacidade de permitir a leitura independente de até 05 cassetes de procedimentos e tamanhos diferentes, e automaticamente procede a leitura dos dados demográficos armazenados na memória dos cassetes de raios-x e mamografia. O digitalizador possui três modos de resolução de imagem de 50,100 e 150 µm. Inclui 01 (um) terminal de visualização, pós processamento, controle de qualidade e tratamento para manipulação básica de imagens de raios-x e mamografia composto de um monitor dicom touch screen de 22" e sistema de cadastramento e identificação eletrônica integrado ao terminal. Permite o armazenamento temporário de no mínimo 2000 imagens. Memória local 2GB HD local 150GB. Digitalização de imagens de alta resolução de 20 pixels/mm para leitura de mamografia e 10 pixels/mm para leitura de raios-x, escala de tons de cinza de 16 bits. Software p/ tratamento de imagens de mamografia, software de supressão de efeito de grade, possui capacidade de reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete, capacidade de leitura de até 100 cassetes/hora dependendo do tamanho e aplicação com resolução. Manipulação de imagens por meio de um software de processamento básico permitindo a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste, brilho e latitude da imagem. Permite a inserção de medidas, ângulos, rotação, inversão de imagens e zoom. Permite a inserção de figuras e textos fixos ou editados pelo usuário. Efetua automaticamente ou manualmente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação. Permite a criação de multilayouts e formatação a partir de 02 imagens diagnósticas na mesma película. Permite exportação para envio de imagens. Placa controladora de rede Fast Ethernet e terminais de cadastramento. DICOM FULL (conexão DICOM 3.0, Storage SCU para imagens brutas (raw data) e pós processadas, Dicom Print para impressão. Permitir conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS. Permite a interligação entre os terminais para otimização de fluxo de processo e troca de informações de pacientes e imagens). Características elétricas: tensão de alimentação 100-240VAC, frequência de alimentação: 50/60 Hz e desligamento automático integrado ao sistema. Acompanha no sistema as quantidades, tipos de cassetes/plates RX sendo: 02un. 35x43cm, 02un. 35x35cm, 02un. 24x30cm, 02un. 18x24cm e mamografia 04un. 18x24cm e 02un. 24x30cm. IMPRESSORA DRY, Marca AGFA, Modelo AXYS Reg. Anvisa: 80497200009 com as seguintes características: DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão	AGFA	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00

IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A - CNPJ: 33.255.787/0001-91 - I.E.: 80.452.712
Matriz: Rua Doutor Sabino Afonso, 187, Manilha - Duque de Caxias / RJ - Cep:25250-413 Tel.: (21)2103-1044 e-mail: licitacoes@ibf.com.br
RJ - Rua Lauro Müller, 114/10º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22270-900 - Tel.: (21)2103-1000
SP - Av. Pedro Bueno, 1.028 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04342-000 - Tel.: (11) 2103-2000

Página 2 de 3

(Handwritten marks and signatures)




INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

<http://www.ibf.com.br>

	DICOM; carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; resolução de impressão de 508 dpi; Spot size mínimo 50 µm; memória mínima expansível 1 GB; controle automático da densidade de cada filme impresso; densidade óptica mínimo 3,2 ; impressão de no mínimo 075 filmes por hora no tamanho 35x43cm; tempo de acesso à 1ª película 35x43cm aproximadamente 65 segundos; resolução de 14 bits; permite o uso de até 2 formatos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento dos 05 formatos oferecidos; permitir a qualquer tempo a troca do tamanho do filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento; impressão por sistema térmico; Utiliza filmes DT2B luz do dia; acesso remoto; tensão de alimentação: 100-240 V. Treinamento no local dos técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização; Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital. Garantia 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. v.u.: trezentos e quinze mil reais. v.t.: trezentos e quinze mil reais.			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (trezentos e quinze mil reais)			R\$ 315.000,00	


- Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os impostos e taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega dos materiais ofertados.

Duque de Caxias, 30 de Junho de 2022.


IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.
CNPJ: 33.255.787/0001-91
Ilacir Resende Ferreira
CPF: 109.111.098-03

IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A - CNPJ: 33.255.787/0001-91 - I.E.: 80.452.712
Matriz: Rua Doutor Sabino Afonso, 187, Manilha - Duque de Caxias / RJ - Cep: 25250-413 Tel.: (21)2103-1044 e-mail: licitacoes@ibf.com.br
RJ - Rua Laura Müller, 114/10º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22270-900 - Tel.: (21)2103-1000
SP - Av. Pedro Bueno, 1.028 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04342-000 - Tel.: (11) 2103-2000

Página 3 de 3





UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.**, inscrita sobre o CNPJ : 33.255.787/0001-91, com sede fabril na Rua Pastor Manoel Avelino de Souza, nº 187 - Xerém - Duque de Caxias - RJ, forneceu a **UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA** os seguintes itens :

01 - Digitalizador, marca AGFA, modelo DX-M completo, para exames de mamografia

01 - Impressora DRY AGFA, modelo AGFA DRY AXYS Mamografia

A citada empresa cumpriu plenamente suas obrigações em relação a este fornecimento, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica até a presente data, que nada consta que possa desaboná-la e a classificamos como empresa idônea e tecnicamente capaz.


Belo Horizonte, 16 de novembro de 2016.



Antônio Sérgio Costa Fragoso

Unidade de Diagnóstico por Imagem Ltda

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
Rua da Bahia, 1009 - Centro - BH - (31) 3014-9000 - 1º andar - Caixa Postal 1009 - Belo Horizonte - MG

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Antônio Sérgio Costa Fragoso*****
Belo Horizonte, 16/11/2016 12:29:24 Stephanie


Esp. R\$4,45 T.F. J: R\$1,38 Total: R\$5,83





Rua: Santa Rita Durão, 74 - loja 05. Funcionários. CEP: 30.140-110. Belo Horizonte - MG. Tel: (31) 3225-2866. Fax: (31) 2555-2866.
E-mail: udibh@uai.com.br Site: www.udibh.com.br

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
Rua da Bahia, 1009 - Centro - BH - (31) 3014-9000 - 1º andar - Caixa Postal 1009 - Belo Horizonte - MG


AUTENTICADO

Compare com o original apresentado. Em 16/11/2016 10:31:23


Esp. R\$4,45 T.F. J: R\$1,38 Total: R\$5,83



Selo de Fiscalização
AUTENTICADO
CQP 27B19





DX-M

SOLUÇÃO CR

O Sistema CR de última geração para mamografia digital e radiologia geral.

- Para mamografia digital e radiologia geral
- Buffer drop-and-go de cassete
- Redução de até 60% na dose com detectores de agulhas de céσιο (*)
- Detectores agulhas e placas-padrão de fósforo



Como última geração em CR para mamografia digital e radiologia geral, o digitalizador DX-M alia uma soberba qualidade de imagem à grande vantagem de permitir os dois tipos de ecrans de fósforo e detectores de agulhas. A exclusiva tecnologia DirectriX permite uma considerável redução de dose. Com um buffer de fácil acesso que pode suportar um misto de 5 cassetes o fluxo de trabalho é mais suave e produtivo. O DX-M pode ser usado como sistema centralizado ou descentralizado, para o departamento de radiologia geral, permitindo exames de mamografia digital e radiologia geral. Em ambiente centralizado, pode ser utilizado para digitalizar várias salas. Simultaneamente, sua pequena dimensão permite que possa ser facilmente instalado em áreas com espaço limitado.

Redução de até 60% na dose (*)

Ao aceitar tanto as placas-padrão de fósforo quanto os detectores de agulha, o DX-M une a total conveniência à alta qualidade de imagem; ao mesmo tempo, alavanca os investimentos já existentes no departamento de radiografia. Com placas-padrão de fósforo, o DX-M produz imagens de excelente qualidade.



Quando utilizado com detectores de agulha de céσιο, contudo, o DX-M fornece imagens de qualidade superior e oferece uma redução substancial na dose, de até 60%.

(*) Testes realizados com um grupo de radiologistas certificados demonstraram que os detectores de brometo de céσιο (CR) e de iodeto de céσιο (DR) quando utilizados com o processamento MUSICA podem oferecer reduções de dose entre 50% e 60% em comparação com os sistemas tradicionais CR de bromofluorato de bário. Para mais detalhes, entre em contato com a Agfa.

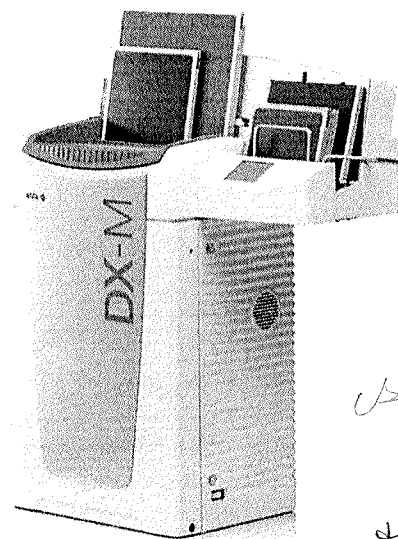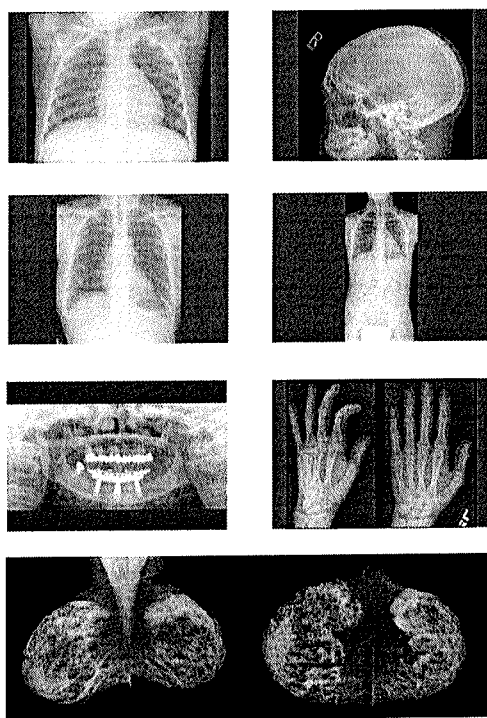



Directrix
Imagem em movimento

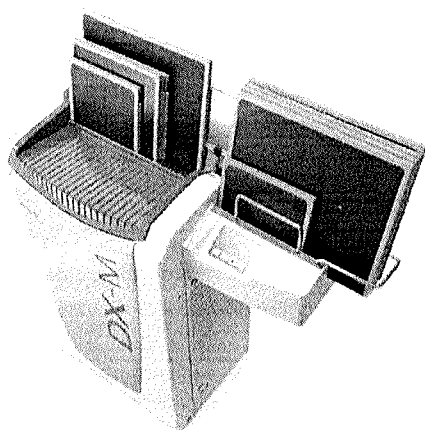

Detector de
agulhas

Ecran de fósforo
standard

Ampla gama de aplicações

A combinação de detectores de agulhas, e de ecrans de fósforo standard com cassetes específicas, e excelente resolução de imagem fazem do sistema DX-M, o ideal para uma ampla gama de aplicações:

- » Mamografia digital
- » Radiologia geral
- » Ortopedia - extremidades
- » Dental
- » Pediatria e neonatal
- » Perna/Coluna completa

Oferece três diferentes modos de resolução de imagem:
50 µm pixel pitch (20 pixels/mm), 100 µm pixel pitch (10 pixels, mm) e 150 µm pixel pitch (6,7 pixels/mm).

Máxima produtividade e fácil fluxo de trabalho

O buffer drop-and-go e a rápida pré-visualização elimina os tempos de espera e facilita um contínuo fluxo de trabalho dentro do departamento.

O buffer automático de 5 cassetes permite manusear um mixto de cassetes de mamografia e de radiologia geral bem como diferentes tamanhos de detectores de agulhas e ecrans de fósforo. O manuseamento automático das cassetes no buffer, faz do DX-M um equipamento de elevada produção e fácil utilização.

Usando o DX-M como um digitalizador central do departamento de radiologia, permite a sua utilização para várias salas de exames. A sua pequena dimensão, faz com que seja facilmente instalado em espaços diminutos, incluindo a sala de rx ou mesmo num pequeno corredor.

A escolha acertada


No sentido de eliminar qualquer confusão, as cassetes dos detectores de agulhas são cinzentas, enquanto as de ecrans de fósforo são de cor laranja, pelo que não existe qualquer possibilidade de o utilizador cometer algum engano na escolha da cassete pretendida. Cada cassete tem incorporada um chip de memória que guarda toda a informação introduzida durante a identificação através de transmissão por rádio frequência. Deste modo, a informação do paciente e a imagem são interligadas desde o início através de um procedimento totalmente digital.

SEGURANÇA

Região	Segurança	EML	Laser
EUROPA	IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 IEC 60601-1:2005	EN 60601-1-2:2007 EN 300 330 2 V1.1.1:2001 EN 301 489 V1.3.1:2001	60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EUA	UL60601-1:2003	FCC part 15	CFR parts 1040.10 e 1040.11
CANADÁ	CSA C 22.2 No.601.1: 1990 + S1:1994 + A2:1998	CSA C 22.2 No. 601.1.2	CSA-E60825-1-03



Detector
de agulhas:
radiologia geral
e mamografia

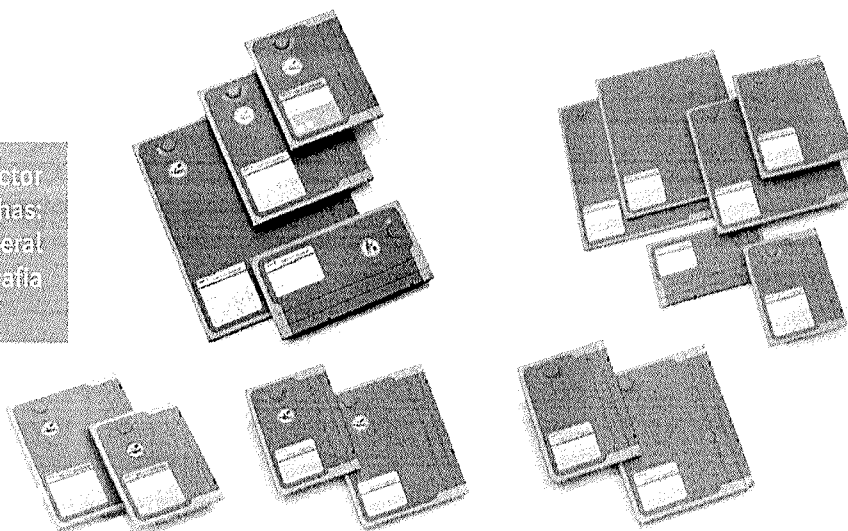

Ecrans de
fósforo standard:
radiologia geral e
mamografia

DETECTORES

Detectores de agulhas	Tamanho	Resolução espacial	Matriz do pixel
▪ CR HD5.0 General SR	35 x 43 cm	6,7 pixels/mm	2272 x 2800
▪ CR HD5.0 General	35 x 43 cm	10 pixels/mm	3408 x 4200
	24 x 30 cm	10 pixels/mm	2256 x 2880
	18 x 24 cm	10 pixels/mm	1656 x 2280
	15 x 30 cm	10 pixels/mm	1344 x 2880
▪ CR HD5.0 AEC	35 x 43 cm	10 pixels/mm	3408 x 4200
	24 x 30 cm	10 pixels/mm	2256 x 2880
	18 x 24 cm	10 pixels/mm	1656 x 2280
▪ CR HD5.0 FLFS	35 x 43 cm	10 pixels/mm	3408 x 4368
▪ CR HM5.0 Mamografia	24 x 30 cm	20 pixels/mm	4708 x 5844
	18 x 24 cm	20 pixels/mm	3508 x 4644
▪ CR HD5.0 Extremidades	24 x 30 cm	20 pixels/mm	4512 x 5760
	18 x 24 cm	20 pixels/mm	3312 x 4560
Ecrans de fósforo	Tamanho	Resolução espacial	Matriz do pixel
▪ CR MD4.0R General SR	35 x 43 cm	6,7 pixels/mm	2320 x 2832
	35 x 35 cm	6,7 pixels/mm	2320 x 2320
▪ CR MD4.0R General	35 x 43 cm	10 pixels/mm	3480 x 4248
	35 x 35 cm	10 pixels/mm	3480 x 3480
	24 x 30 cm	10 pixels/mm	2328 x 2928
	18 x 24 cm	10 pixels/mm	1728 x 2328
	15 x 30 cm	10 pixels/mm	1440 x 2928
▪ CR MD4.0R FLFS SR	35 x 43 cm	10 pixels/mm	3480 x 4392
▪ CR MM3.0R Mamografia	24 x 30 cm	20 pixels/mm	4710 x 5844
	18 x 24 cm	20 pixels/mm	3510 x 4644



Especificações Técnicas

GERAL

Buffer "drop-and-go"

- » Buffer receptor de 5 cassetes de diversos tamanhos e buffer de saída de 5 cassetes de diversos tamanhos

Produção

- » Velocidade: até 100 placas/hora (Dependendo do tamanho e da resolução)

Display de indicação de erros e do estado

- » LCD ecran táctil
- » LED indicador de estado

Resolução de escala de cinzentos

- » Saída para o processador: 16 bits/pixel compressão raiz quadrada

Dimensões e peso

- » Fundo (L x C x A): 660 x 510 x 1230 mm
- » Buffer saída incluído (L x C x A): 1150 x 510 x 1230 mm
- » Peso: aprox. 180 kg

Requisitos de configuração

- » Estação de trabalho e fluxo de trabalho NX
- » ID tablet
- » CR HD5.0 Detectores e Cassetes
- » CR MD4.0R Placas e Cassetes
- » Seja Detectores CR HM5.0 MAMMO e Cassetes ou Placas CR MM3.0R MAMMO e Cassetes

Alimentação

- » 220 - 240 V/50-60 Hz
Standby 87 W, pico 590 W, fusível 16 A
- » 120 V/60 Hz (EUA)
Standby 92 W, pico 621 W, fusível 15 A
- » 100 V/60 Hz (Japão)
Standby 92 W, pico 621 W, fusível 15 A

Condições ambientais

Digitalizador DX-M

- » Temperatura: +15 ~ +30° C
- » Temperatura para uso com CR HM5.0 MAMMO Detector: +20 ~ +30° C
- » Umidade: 15 ~ 75% UR
- » EMC compatível IEC 60601-1-2
- » Variação de mudança de temperatura: 0,5° C/minuto

Transporte

- » Temperatura: -25 ~ +55° C, -25° C para max. 72 hora, +55° C para max. 96 hora
- » Umidade: 5 ~ 95% UR

Efeitos ambientais

- » Nivel de ruído: max. 65 dB (A)
- » Dissipação de calor: standby 92 W, operação contínua 242 W

SEGURANÇA

Homologações

- » ETL classificado CUS, CE

Para mais informações sobre a Agfa, visite nosso site em www.agfa.com

Agfa e Agfa names são marcas e patentes de Agfa-Gevaert NV, Bélgica, ou das suas filiais, Directrix, e Linc. "Mammox" e DX-M são marcas registradas da Agfa-Gevaert NV, Bélgica, ou das suas filias. Todos os direitos reservados. Toda informação contida aqui é destinada apenas para orientação. As características dos produtos e dos serviços descritos nesta publicação podem ser alterados em qualquer momento sem aviso prévio. Os produtos e serviços podem não estar disponíveis para a sua região. Para mais informações, consulte o representante local para informações de disponibilidade. A Agfa-Gevaert NV não se responsabiliza por qualquer erro tipográfico.

© 2011 Agfa NV
Todos os direitos reservados
Publicado pela Agfa NV
Septembru 27 - 2010
Bélgica


SEMPRE EM MOVIMENTO

AGFA



Drystar® AXYS

Impressora

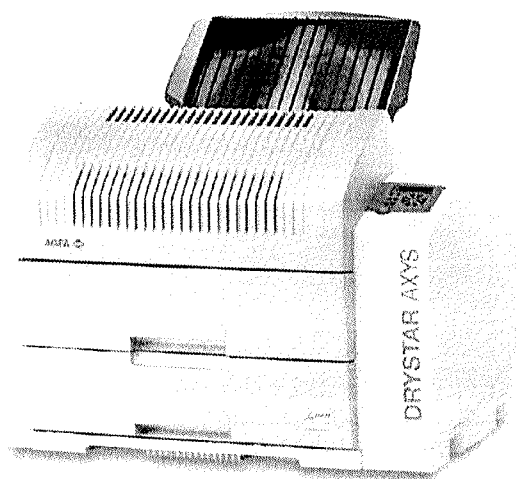

Sistema Flexível de Impressão de Imagem, de mesa, que produz imagens com qualidade de diagnóstico para mamografia.

A DRYSTAR AXYS TRABALHA COM DOIS TAMANHOS DE FILME ON-LINE; UM SISTEMA DE IMAGEM DIGITAL COM EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM.

- Solução de impressão multi-aplicativos;
- Imagens com qualidade de mamografia, com resolução de 508dpi;
- Tempo de acesso curto para produção extremamente rápida das 4 primeiras impressões;
- Impressão conveniente, com dois tamanhos de filme online;
- Confiável, flexível e acessível.

Pequenas dimensões, enorme potencial.


A DRYSTAR AXYS oferece uma enorme gama de possibilidades apesar de seu tamanho compacto, podendo ser usada em fluxos de trabalho centralizados e com aplicações dedicadas. Atendendo uma ampla variedade de aplicações ela possibilita o manuseio à luz do dia das duas bandejas de mídia, com cinco tamanhos de filmes dry, e três tipos diferentes de mídia à disposição. A impressora oferece, portanto, maior flexibilidade e conveniência. A capacidade de usar mídias de tamanhos variados permite a DRYSTAR AXYS atender à todas as aplicações. Adicionalmente, seu tempo de acesso ultra-rápido para as primeiras cinco impressões permitem otimizar a produtividade.

Diagnóstico de Imagem Direto Digital:

Mais confiabilidade para mais disponibilidade. Assim como em toda a família de impressoras da AGFA, a DRYSTAR AXYS incorpora o Diagnóstico de Imagem Direto Digital (DDI). Esta tecnologia permite o uso de componentes óticos complexos para um diagnóstico de imagem com projeto mais confiável e durável. Fora isso, a DRYSTAR AXYS é ecológica e fácil de usar, não necessitando de processamento úmido, câmara escura, ajustes complicados ou procedimentos de limpeza. Produtos químicos danosos ao meio-ambiente, manuseio de resíduos e custos de disposição são coisas do passado.

Imagens de mamografia de alta qualidade de um dispositivo para diagnóstico por imagem de mesa

Com a DRYSTAR AXYS, o departamento de mamografia poderá aproveitar toda a conveniência de uma impressora digital de imagens de mesa. Sua alta resolução de 508dpi é perfeitamente adequada ao modo de resolução de 50µm, sem interpolação. O resultado é uma qualidade superior de imagem, necessária para as imagens de diagnóstico por mamografia. Ainda assim, a DRYSTAR AXYS oferece a mesma confiabilidade, acessibilidade e tamanho conveniente de todas as impressoras da família DRYSTAR da Agfa Healthcare.

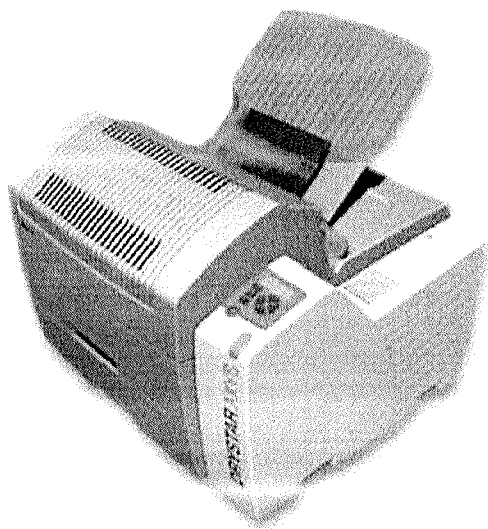

O tamanho certo para ambientes centralizados e dedicados

A DRYSTAR AXYS é a solução certa para locais menores, que tenham limitações de espaço e menor volume de pacientes, assim como clínicas maiores, com muitos departamentos. Como impressora centralizada, ela suporta uma ampla gama de aplicações, incluindo Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Angiografia de Subtração Digital (DSA) e Ultra-som, assim como aplicações de Radiografia Computadorizada para aparelhos de Raios-X, Mamografia, Ortopedia, Odontologia, etc. Da mesma forma, seu projeto compacto lhe permite ser uma impressora dedicada, por exemplo, para o departamento de mamografia digital.

Fácil conectividade para o máximo de flexibilidade

A DRYSTAR AXYS é uma impressora nativa DICOM, que torna fácil sua conectividade à rede. Para conexões ponto-a-ponto com modalidades não-DICOM, a DRYSTAR AXYS pode ser usada com a LINX Paxport da AGFA.

A*Sharp: Melhorando a qualidade da imagem

Como parte do nosso esforço contínuo para lhe oferecer a melhor qualidade de imagem, nossa premiada tecnologia de Diagnóstico de Imagem Direto Digital (DDI) foi melhorada com a inclusão da tecnologia A*Sharp. Esta tecnologia intensifica a capacidade de produção de imagem, permitindo ao sistema DDI fornecer imagens mais claras em todas as aplicações.





Especificações Técnicas

Geral	Desempenho
<p>Dimensões (LxPxA)</p> <ul style="list-style-type: none">• 72,8 x 71,5 x 53,6 cm (A = 67,6 cm com a bandeja de saída).• 28,7 x 28,1 x 21,1 pol (H= 26,6 pol com a bandeja de saída). <p>Peso (sem filme)</p> <ul style="list-style-type: none">• 90kg (198 libras) <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleção automática 100-240V, 50-60Hz. <p>Consumo de energia</p> <ul style="list-style-type: none">• Em impressão: 250W;• Pico: 530W; e• Espera: 70W. <p>Capacidade da bandeja de alimentação</p> <ul style="list-style-type: none">• 100 folhas por bandeja de alimentação. <p>Condições de armazenamento/transporte</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 15-30°C (59-86°F)• Umidade: 20-75%, sem condensação. <p>Segurança</p> <ul style="list-style-type: none">• IEC 606001-1;• UL 60601-1;• CSA 22.2, Nº 601.1 M90• VDE 0750• Selos de Segurança UL, cUL, TÜV-Mark	<p>Fluxo de Produção</p> <ul style="list-style-type: none">• 35x43cm: 75 películas/hora;• Tempo de acesso à 1ª película 65 segundos (35x43cm);• 20x25cm: 130 folhas/hora para mamografia;• Tempo de acesso à 1ª película 40 segundos (20x25cm mamografia). <p>Área de diagnóstico</p> <p>Radiografia Geral</p> <ul style="list-style-type: none">• 20x25cm: 3.852 x 4.880 pixels;• 35x43cm: 6.992 x 8.368 pixels; <p>Mamografia</p> <ul style="list-style-type: none">• 20x25cm: 3.828 x 4.958 pixels;• 25x30cm: 4.892 x 5.810 pixels; <p>Resolução em impressão</p> <ul style="list-style-type: none">• Geométrica: 508dpi;• Contraste: 14-bit em impressão. <p>Filme</p> <p>Tipos</p> <ul style="list-style-type: none">• DRYSTAR DT2 B: base azul;• DRYSTAR DT2 C: base transparente;• DRYSTAR DT2 MAMMO. <p>Tamanhos</p> <ul style="list-style-type: none">• DT2 B + DT2 C: 20x25cm; 25x30cm; 28x35cm, 35x35cm e 35x43cm;• DT2 B MAMMO: 20x25cm; 25x30cm; 28x35cm;• Dois tamanhos online, qualquer tipo ou tamanho.

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



A Agfa e a Agfa rhombus são marcas registradas da Agfa-Gevaert N.V., Bélgica, ou de suas afiliadas. A DRYSTAR LINX™ Paxport e a A*Sharp são marcas registradas da Agfa HealthCare NV, Bélgica, ou de suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas são mantidas por seus respectivos proprietários e usadas em um padrão editorial sem nenhuma intenção de violação.

Os dados nesta publicação tem como objetivo somente a ilustração e não representam necessariamente padrões ou especificações, que devem ser fornecidos pela Agfa HealthCare.

Toda informação neste contida tem como objetivo somente a orientação, e as características dos produtos e serviços podem não estar disponíveis em sua localidade. Favor contatar seu representante de vendas local para informações sobre a disponibilidade.

A Agfa healthCare se prontifica a fornecer as mais específicas informações, porém não se responsabiliza por qualquer erro tipográfico.

A Agfa HealthCare NV foi outorgada com certificado o ISO 9001 pela Lloyd's Register Quality Assurance e com o certificado ISO 13485 pelo design, desenvolvimento e produção de imagem e resolução de comunicação para os aplicativos da HealthCare.

A DICOM é a marca registrada da Associação nacional de fabricantes Elétricos para sua publicação padrão referente à comunicação digital de informações Médicas



© 2007 Agfa HealthCare NV
All rights reserved
Published by Agfa HealthCare NV
B-2640 Mortsel - Belgium
NGO3R GB 00200710



MATRIZ IBF
Rua Lauro Muller, 116/10º andar - Botafogo
CEP: 22290-906 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: (21) 2103-1000
medix@ibf.com.br

IBF FILIAL SP
Av. Pedro Bueno, 1028 - Jabaquara
CEP: 04342-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 2103-2000
rxsp@ibf.com.br

@ibf.medix @ibf.medix www.ibf.com.br






Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AGFA DO BRASIL LTDA
CNPJ	09.032.626/0001-54
Autorização	8.04.972-0
Produto	IMPRESSORA DRYSTAR

Modelo Produto Médico
CRYSTAL IMAGER
CRYSTAL-M IMAGER
Drystar AXYS
Drystar 4500
Drystar 4500 M
Drystar 5300
Drystar 5302
Drystar 5500
Drystar 5503

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ADENDO - MANUAL DO USUÁRIO - CRYSTAL IMAGER.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ADENDO - MANUAL DO USUÁRIO - CRYSTAL-M IMAGER.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ADENDO - MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 4500 M.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ADENDO - MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 5300.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ADENDO - MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 5302.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ADENDO - MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 5500 E 5503.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ADENDO - MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR AXYS.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR AXYS - RV_2852E PT 20191008 0826.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 5500 E 5503 - RV_2901I PT 20091001.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:13
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 4500 M- RV_2811D PT 20070801.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:11
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 5300 - RV_2921G PT 20130208.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:11
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - DRYSTAR 5302 - RV_2831F PT 20210601	0349244227 - 27/01/2022 14:49:11



INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - CRYSTAL IMAGER - RV_3831B_PT_20210601_1655.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:10
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - CRYSTAL-M IMAGER - RV_3852B_PT_20210601_1655.PDF	0349244227 - 27/01/2022 14:49:10

Nome Técnico	Impressora para Imagens Medicas
Registro	80497200009
Processo	25351084153201011
Fabricante Legal	AGFA GEVAERT HEALTHCARE GMBH, AGFA NV
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

[Handwritten marks]



PORTAL EXTRAJUDICIAL

CONSULTA DE SELOS EXTRAJUDICIAIS

Dados do Serviço Extrajudicial

Código	710
Nome	CAPITAL 10 OF DE NOTAS
Endereço	Avenida Nilo Peçanha - 26 - Ij, sbl, 2º e 3º andares
CEP	20020-100
Bairro	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO
Comarca	Comarca da Capital
Telefones	(21) 2544-3023/ 2215-1021/ 2215-2858/ 2215-2859/2272-1950/2524-5332
Observação	

Dados do Ato Extrajudicial

Selo	EDOH86157
Código Aleatório	PCX
Tipo de Ato	Lavratura de Procuração
Data da Prática	08/10/2020
Tipo de Cobrança	Com Cobrança
Nº Livro	2060
Nº Ato	125
Nº Folha Inicial	144
Nº Folha Final	144
Tipo do Livro CNJ	P
Finalidade da Procuração	Que versem sobre bens móveis, imóveis e valores de forma geral
Tipo do Livro de Notas	Procuração
Nota de Distribuição	854772



Participantes

Nome	Nomeclatura	Data Nascimento	CPF / CNPJ	Identidade	Orgão Emissor	Estado Civil	Nacionalidade	Just. CPF/CNPJ
ILACIR RESENDE FERREIRA	16 - OUTORGADO	28/06/1958	10911109803	13237854	SSP/MG	Casado		
AUREA resende BUZATTI	232 - MÃE							
palmeiro ferreira buzatti	231 - PAI							
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	17 - OUTORGANTE		33255787000191					

Emolumentos

Emolumentos	301.18
FETJ	60.23
FUNDPERJ	15.05
FUNPERJ	15.05
FUNARPEN	12.04
RESSAG	5.28
Valor Mútua	0.00
Valor Acoterj	0.00
Valor Distribuidor	30.19

Histórico de Transmissões/Retificações

Status	Selo	Aleatório	Data da Prática	Tipo de Ato	Tipo de Cobrança	Data de Transmissão
Transmitido	EDO86157	PCX	08/10/2020	Lavratura de Procuração	Com Cobrança	16/10/2020 13:22:45



Número de Consulta: 6823123

Data/Hora: 08/07/2021 12:01:59

Data/Hora Transmissão: 16/10/2020 13:22:45

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Av. Erasmo Braga, 115 - 7º e 8º andares - Lâmina I - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP:20020-903 - Telefone - (21)3133-2000
E-mail - corregedoria@tjrj.jus.br
Copyright © 2011

R

f

ca



LONDRINA, 30 de JUNHO de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ESTADO DO CEARÁ

Secretária Municipal de Administração
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletronico N° 039/2022

LondriHosp
Produtos Hospitalares

PROPOSTA

LOTE	QDTE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
03	01	ELETROCARDIOGRAFO / 12 CANAIS - DESCRITIVO CONFORMTE TERMO DE REFERENCIA	COMEN / CM	10000,00	10.000,00
			VALOR TOTAL DA PROPOSTA		10.000,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS					


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA

CPF: 084.265.219-16

ADMINISTRADOR

GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:0842652191

6

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010817368,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB,
ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA,
cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A empresa LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, concordando e acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: Conforme edital.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia e Assistência Técnica: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 30.803-X

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

Gustavo Henrique Carrega

CPF: 084.265.219-16 RG: 12.640.687-8

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na condição de MICROEMPRESA e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição, e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para execução do objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados na presente licitação.

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar, caso ocorram fatos posteriores que nos inabilite a participar de licitações. Declaramos




ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública.

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, NÃO POSSUINDO, AINDA, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos.

Declaramos que os sócios e seus representantes não possuem parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com os servidores e agentes políticos envolvidos no processo licitatório, e com poder decisório capaz de influenciar no resultado, independentemente da modalidade licitatória.

Declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração da licitante, antes da abertura oficial das propostas.

Londrina, 30 de junho de 2022.


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:084265219

16

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CARREGA.08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010817368, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ 03.580.620/0001-35 **Autorização** 8.00.473-0
Produto ELETROCARDIOGRAFO

Modelo Produto Médico

CM1200
 CM1200A
 CM1200B
 CM300
 CM600 (CM300A & CM100A)
 CM100.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso_CM1200A_18527.pdf	1597800/21-0 - 26/04/2021 - 05:21
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso_CM1200B_18527.pdf	1597800/21-0 - 26/04/2021 - 05:21
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso_CM1200_18527.pdf	1597800/21-0 - 26/04/2021 - 05:21
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso_CM600 CM600 (CM300A & CM100A),18527.pdf	1597800/21-0 - 26/04/2021 - 05:21

Nome Técnico Eletrocardiografo
Registro 80047300498
Processo 25351.167306/2013-18
Fabricante Legal • FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI



Página 1 de 2

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ESTADO DE CEARÁ
PREGÃO ELETRONICO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
Nome Fantasia: BRUMED				
CNPJ: 31.770.650/0001-40		Inscrição Estadual: 096/3759680		Inscrição Municipal 30213622
Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997		CEP: 91130-480		Município: PORTO ALEGRE-RS
Telefones: 51 3779-9887 * 3779-9771		E-mail: brumedadm@gmail.com; brumedvendas@gmail.com		
Banco BANCO DO BRASIL		Agência 2867-3		Conta 54235-0
Representante Legal: RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG		CPF: Nº 957.968.000-00		RG: Nº 8070538262
Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997		Bairro: SARANDI		Estado Civil: SOLTEIRO
Cargo: PROPRIETÁRIO		Qualificação: REPRESENTANTE LEGAL		Nacionalidade: BRASILEIRO
		Cidade: PORTO ALEGRE		CEP: 91130-480

ITEM	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
04	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Marca: CONTEC Modelo: MAX ECG	UN	01	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL – R\$ 6.000,00 (Reais)					

- Condições de Pagamento: conforme edital.
- Prazo de Validade da Proposta: CONFORME EDITAL
- Prazo de Entrega e garantia: conforme edital.
- Local de entrega: conforme edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

À Prefeitura Municipal.

Estamos fornecendo nossa proposta financeira, acatando todas as exigências editalíssimas e referente ao Edital tipo Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos DESCRITOS ACIMA: Obs.: Declaramos que, nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os equipamentos ofertados, inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e de materiais e transporte, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita entrega dos equipamentos.

Obs.: Declaramos que somos Assistência Técnica dos equipamentos por nós ofertados e que dispomos de peças originais, caso haja necessidade.

Obs.: Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI



Página 2 de 2

Obs.: Declaramos que os produtos serão fornecidos de acordo com as descrições técnicas detalhadas, deste edital, bem como, com as normas de segurança, padrões de qualidade e no prazo solicitado.

OBSERVAÇÃO*INFORMAMOS: Que todos os itens OFERTADOS pela empresa licitante, após análise de nosso departamento técnico ao termo de referência, são, no mínimo, similar, compatível ou superior ao que se pede em edital. Neste sentido, é de extrema importância e NECESSÁRIO, que essa renomada CPL e o Sr.(a) pregoeiro(a), juntamente com a área técnica e/ou solicitante, faça suas análises minuciosamente e criteriosa através do catálogo enviando juntamente com a proposta, a fim de comprovar se o equipamento/produto OFERTADO, atende a todos os requisitos e necessidade desta instituição. Ainda assim, estaremos incluindo na proposta, marca e modelo dos itens OFERTADOS, que após análise, aceite, adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entrega aqueles itens conforme constantes em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.

Porto Alegre – RS, 30 de JUNHO de 2022.

BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCA
O DE
EQUIPA:31770
650000140

Assinado de
forma digital por
BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCAO
DE
EQUIPA:3177065
0000140

31.770.650/0001-40

BRUMED COMERCIO ATAC. E MANUT.
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA ZEFERINO DIAS, 997
SARANDI - CEP 91130-480

PORTO ALEGRE - RS

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ nº 31.770.650/0001-40**

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI.**

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



Consultas


ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI-ME
CNPJ	07.760.277/0001-61
Autorização	8.02.989-7
Produto	ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG


Modelo Produto Médico
ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG 1
ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG 12
ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG 12 Plus
ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG 3
ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG 3 Plus

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Sistema de Análise de ECG
Registro	80298979004
Processo	25351325021202038
Fabricante Legal	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>



ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG 300G

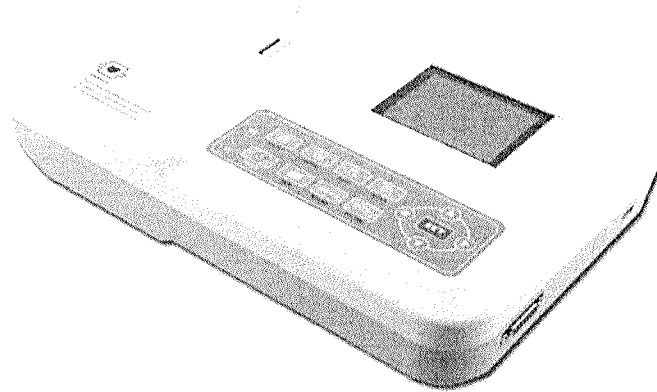

Suas funções são as seguintes:


Gravação e exibição de formas de onda de ecg no modo automático / manual; Auto-medição e auto-diagnóstico dos parâmetros da onda de ecg; Levando o estado de lead off e falta de papel; Alternando vários tipos de linguagens de interface; Gerenciando o banco de dados de casos.

Características:

A tela lcd colorida tft de 3,5 mostra o status de trabalho e a forma de onda de ecg. Verifique a forma de onda antes de imprimir para salvar o papel de registro.

Aquisição de ecg de 12 derivações, processador de sinal digital, para obter formas de onda de ecg de maior qualidade através do filtro ca, filtro de linha de base e filtro emg dos sinais de ecg. Exibição simultânea de 3/6/12 leva forma de onda de ecg e o estado do modo de impressão, sensibilidade, velocidade, filtro etc., para ser fácil para interpretação. Incluir modos de impressão multiformatos e formato, como auto 3 4 +1, auto 3 4, auto 2 6 +1, auto 2 6, auto 4 3, ritmo 4, ritmo 3, ritmo 2 e manual etc; a duração da impressão em ondas pode ser ajustada e a função de impressão periódica é incluída para satisfazer diferentes aplicações.

O instrumento tem a função de auto-análise regular e auto-interpretação do parâmetro de forma de onda de ecg, fornece parâmetros de medição como hr, intervalo pr, duração p, duração qrs, duração t, intervalo qt, q-tc, eixo p, eixo qrs, eixo t, r (v5), s (v1), r (v5) + s (v1) etc e conclusão de interpretação automática para ajudar a reduzir a abundância do médico e melhorar a eficiência do trabalho.



A fonte de alimentação inclui ambos os ca / cc. Este dispositivo inclui bateria recarregável de polímero de lítio incorporada. Ele pode aguardar por 10 horas, imprimir 260 pedaços de ecg e imprimir 180 minutos continuamente sob o melhor estado de cc, para satisfazer a necessidade de pacientes em visita e exame físico. Ele tem armazenamento embutido com grande capacidade e memória de mais de 1000 casos, o que é fácil para a revisão e estatística do médico. Suporte chinês, inglês, espanhol, turco, polonês, italiano, francês, alemão, português, cazaquistão, interface operacional russo, pode imprimir tais relatórios de linguagem dos itens acima.

Especificação técnica:

Tipo de segurança: classe i, parte aplicada do tipo cf, que tem parte aplicada à prova de desfibrilação Chumbo

Modo de entrada: flutuante e proteção de desfibrilação

Corrente de fuga do paciente: 10 μ a

Taxa de amostragem: 1000hz

Conversão a / d: 12bit

Resposta de freqüência: 0.05hz ~ 150hz (-3db ~ + 0.4db)

Constante de tempo: =3.2s

Cmrr: 60db, 100db (com filtro ac)

Tensão de polarização duradoura: \pm 500mv

Nível de ruído: =15 μ vp-p

Filtro de interferência emg: 25hz / 35hz (-3db)

Filtro ac: 50hz / 60hz (=20db)

Modo de gravação: sistema de impressão térmica (8 pontos / mm)

Papel de gravação: 80mm (w) x 20m (l)

Sensibilidade: 2,5 mm / mv 5 mm / mv 10 mm / mv 20 mm / mv 40 mm / mv

Velocidade do papel:

Auto-modo: 25mm / s, 50mm / s

Modo manual: 5 mm / s, 6,25 mm / s, 10 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s

Fonte de alimentação: ac: 100/240 v, 50/60 hz dc: 7.4 v, 3700 mah bateria de lítio recarregável

Especificação do fusível: atraso de tempo da ca de 2 pcs f5 x 20mm; t1.6al250v

Tamanho: 315 mm (l) x 215 mm (l) x 77 mm (a)

Peso líquido: 1,6 kg

Anvisa nº 80298979004

Acessórios:

Um ecg leva

Um grampo de eletrodo de membro

Um eletrodo de peito

Um conexão de energia

Um fio terra

Um manual do usuário

Um software + cabo usb



Planilha de custos por equipamento	custo	frete até empresa	frete até cliente	imposto 11 %	Preço de venda	Lucro
ELETRO	R\$4 200	R\$110,00	R\$110,00	R\$462,00	R\$6 000,00	22%

[Handwritten marks]